

令和6年11月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定試薬の変更に伴い内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 敬白

\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*


### ■内容変更項目

#### 項目コード No.24331 インターロイキン-6(ECLIA)


	新	旧
項目コード No.	24332	24331
検査項目名	インターロイキン-6(CLEIA)	インターロイキン-6(ECLIA)
測定方法	CLEIA	ECLIA
基準範囲(単位)	5.8以下 (pg/mL)	7.0以下 (pg/mL)
報告範囲	0.3未満 0.3~999 1000以上	1.5未満 1.5~99900000
保存(安定性)	凍結(21日)	凍結

### ■新旧の比較

【全体】

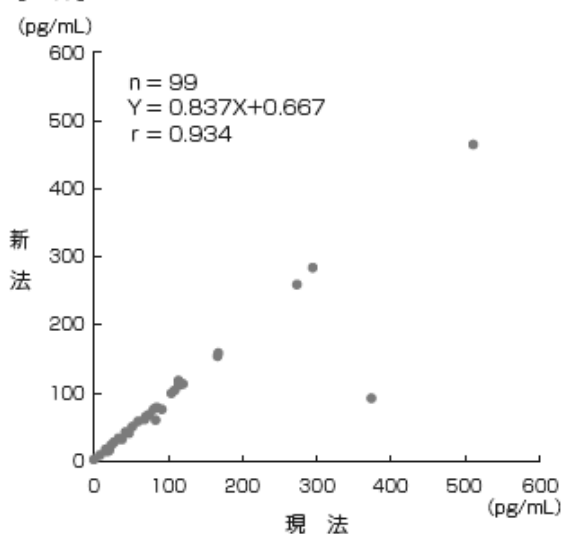

【低濃度域】

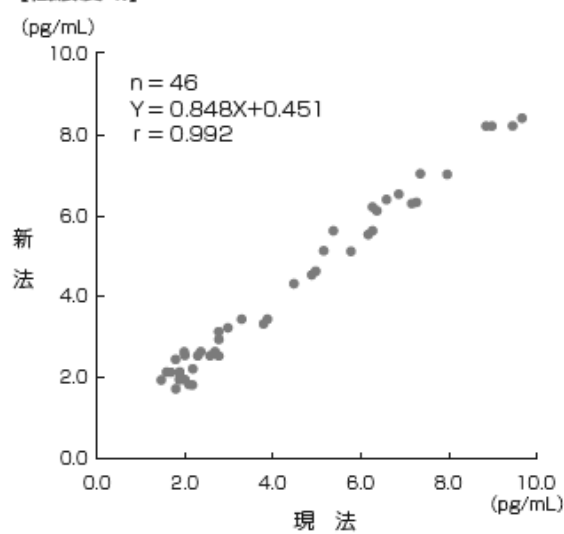

(委託先資料)

### ■変更期日

令和6年12月5日(木) 受付分より

以上

24-1124